




EQUATORIAL AUDIO

## Mjerač Provisa Kabela

±0,02mm preciznosti · Gravitacijska kalibracija:  $g = 9,780 \text{ m/s}^2$

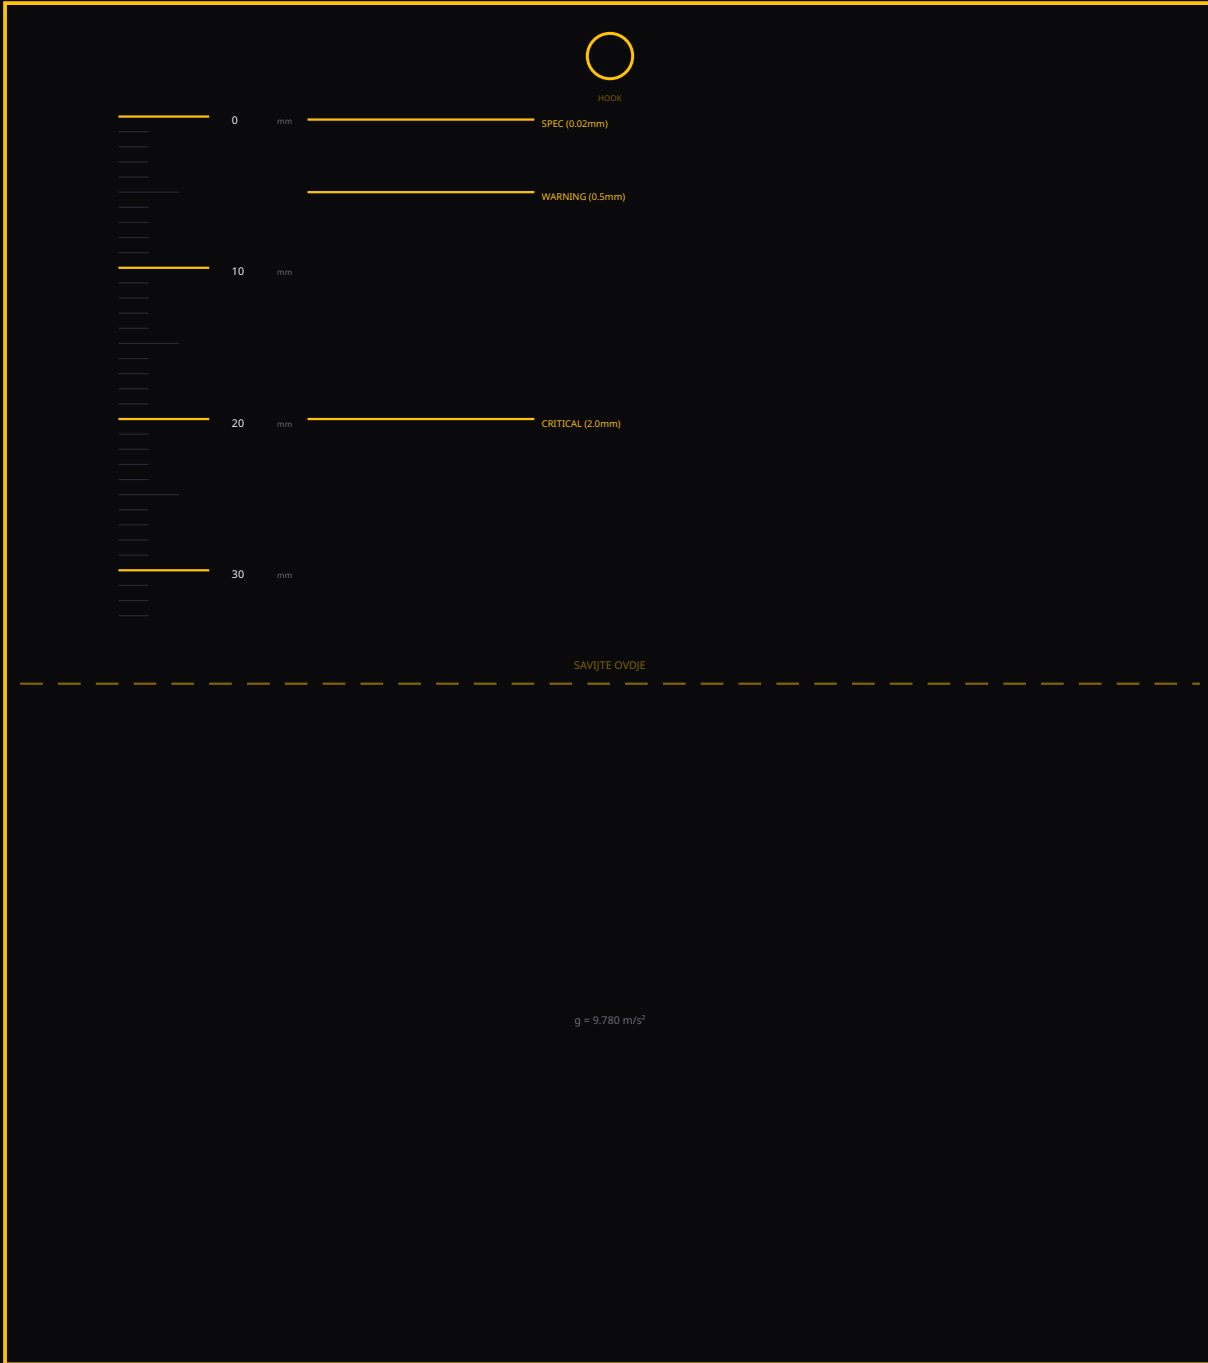

### UPUTE

Savijte duž printanih vodilica. Objesite s kabela na sredini. Očitajte mjerenje provisa sa graduirane skale. Ponovo kalibrišite ako ambijentalna temperatura prelazi 28°C.