




EQUATORIAL AUDIO

Kabelhæng-måleinstrument

±0,02 mm præcision • Gravitationskalibrering: $g = 9,780 \text{ m/s}^2$

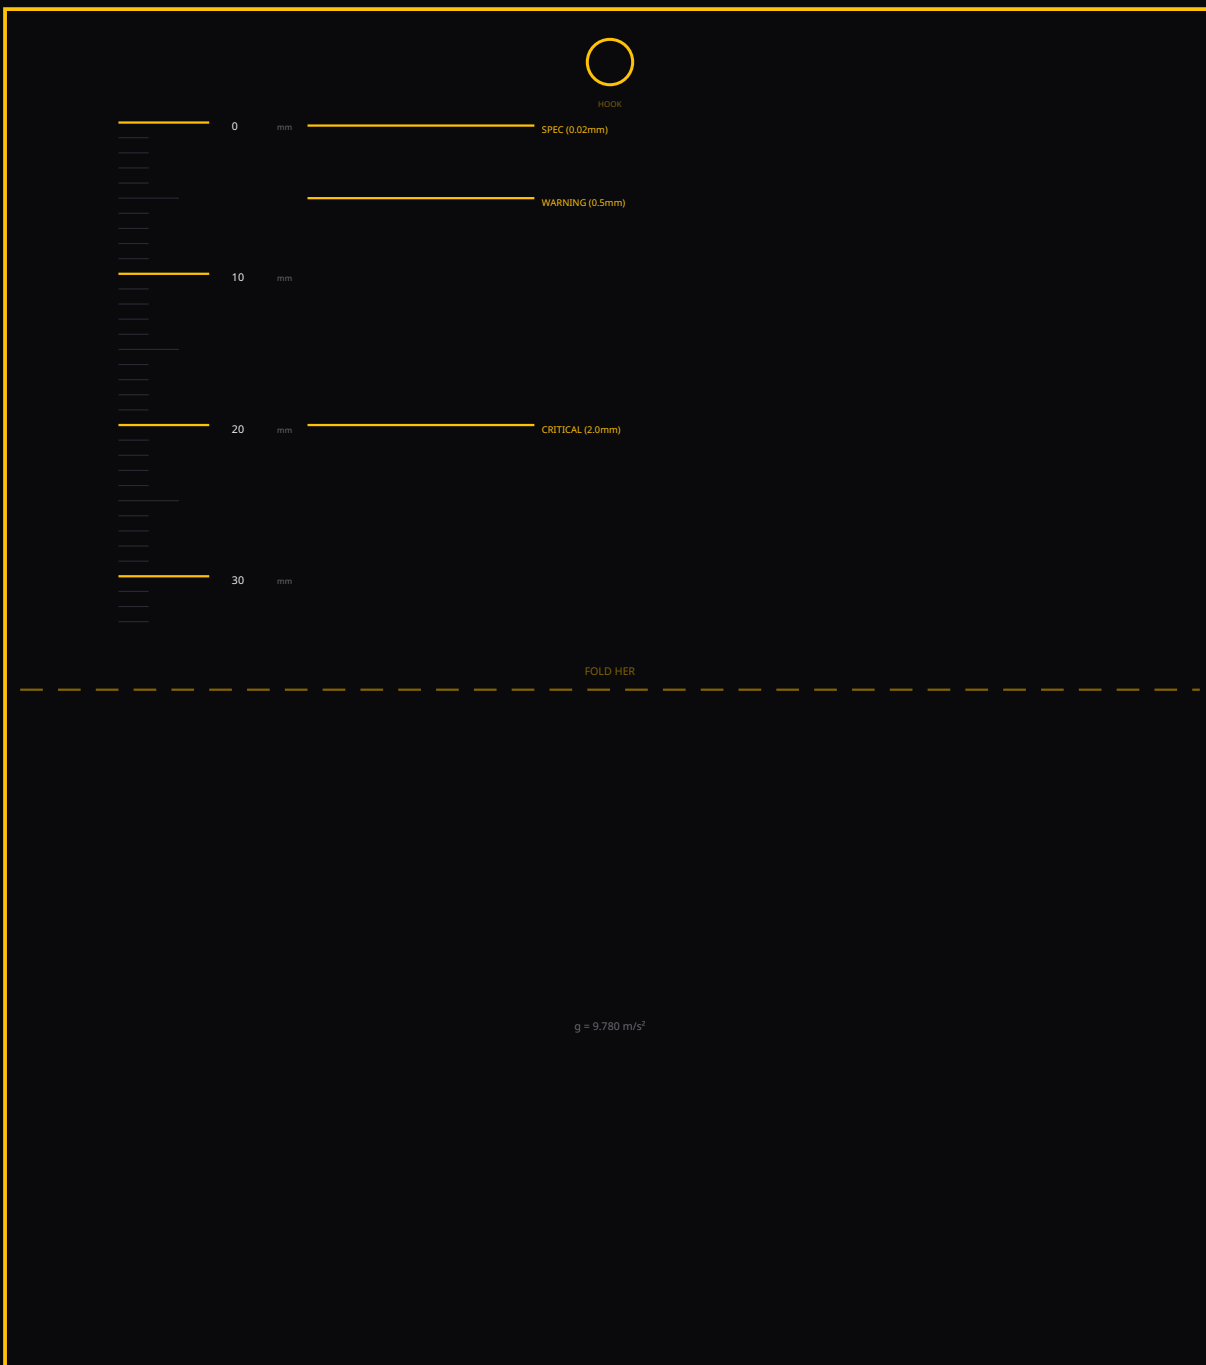

INSTRUKTIONER

Fold langs trykte guider. Ophæng fra kabel ved midtpunkt. Aflæs hængmåling fra graderet skala. Rekalibrér, hvis omgivelsestemperaturen overstiger 28°C.